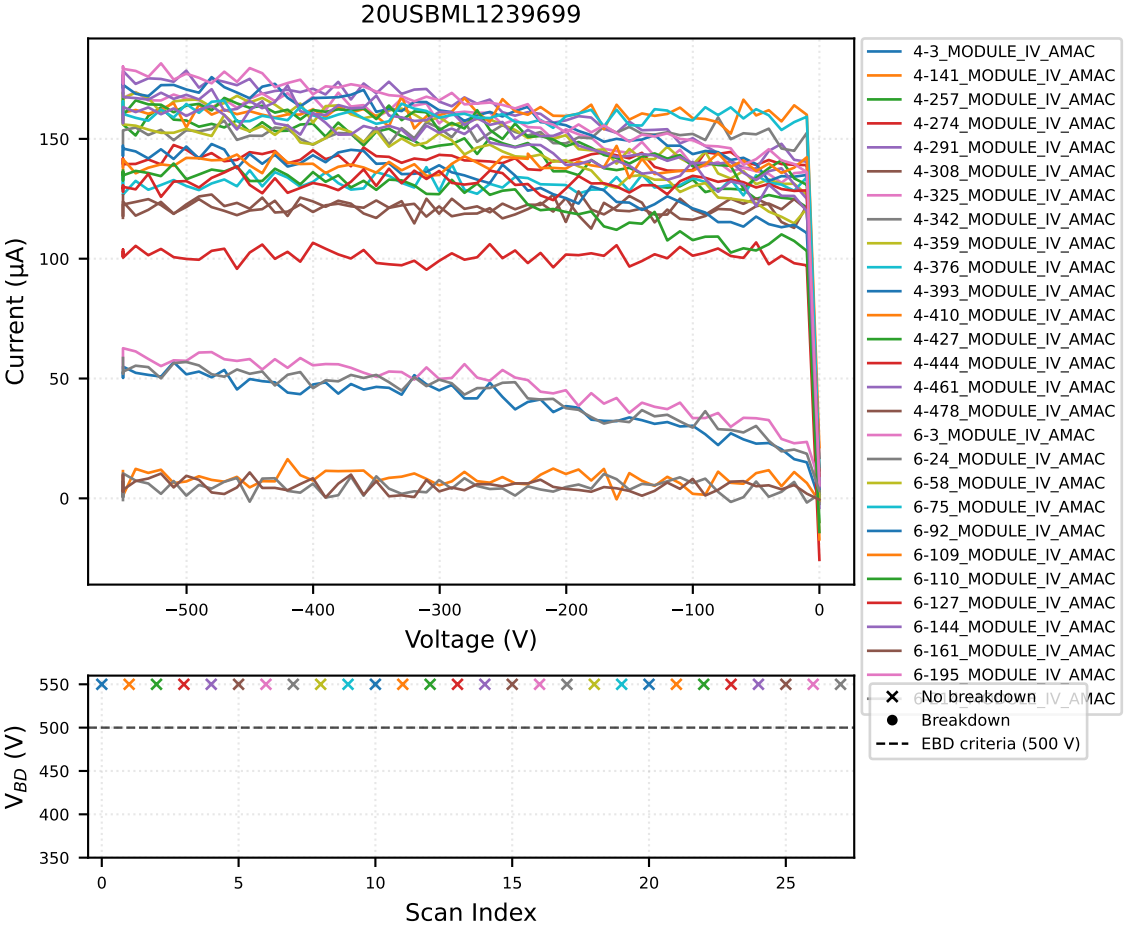
20USBML1239699
Current (μA)
Voltage (V)
V_{BD} (V)
Scan Index
4-3_MODULE_IV_AMAC
4-141_MODULE_IV_AMAC
4-257_MODULE_IV_AMAC
4-274_MODULE_IV_AMAC
4-291_MODULE_IV_AMAC
4-308_MODULE_IV_AMAC
4-325_MODULE_IV_AMAC
4-342_MODULE_IV_AMAC
4-359_MODULE_IV_AMAC
4-376_MODULE_IV_AMAC
4-393_MODULE_IV_AMAC
4-410_MODULE_IV_AMAC
4-427_MODULE_IV_AMAC
4-444_MODULE_IV_AMAC
4-461_MODULE_IV_AMAC
4-478_MODULE_IV_AMAC
6-3_MODULE_IV_AMAC
6-24_MODULE_IV_AMAC
6-58_MODULE_IV_AMAC
6-75_MODULE_IV_AMAC
6-92_MODULE_IV_AMAC
6-109_MODULE_IV_AMAC
6-110_MODULE_IV_AMAC
6-127_MODULE_IV_AMAC
6-144_MODULE_IV_AMAC
6-161_MODULE_IV_AMAC
6-195_MODULE_IV_AMAC
No breakdown
Breakdown
EBD criteria (500 V)